

『音声とビジュアルで学ぶ犬と猫の聴診ガイド』(1刷) 訂正とお詫び

ISBN978-4-89531-985-0

下記の箇所に誤りがございました。訂正するとともに深くお詫び申し上げます。

株式会社 緑書房

訂正箇所

【誤】

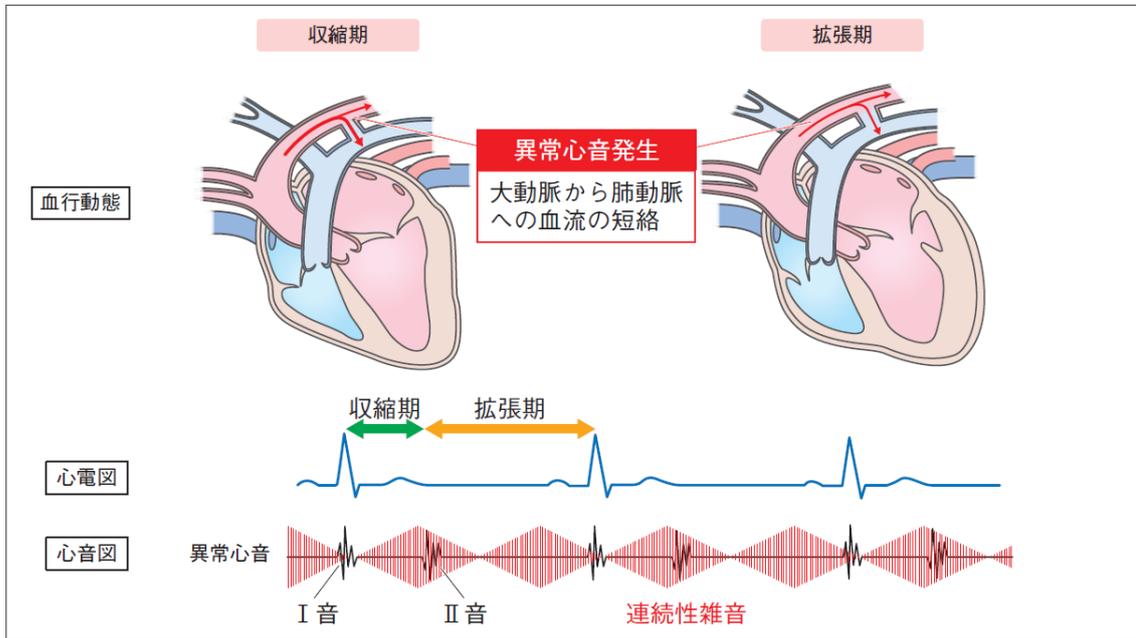


図 3-1-5 動脈管開存症における連続性雑音の発生

【正】

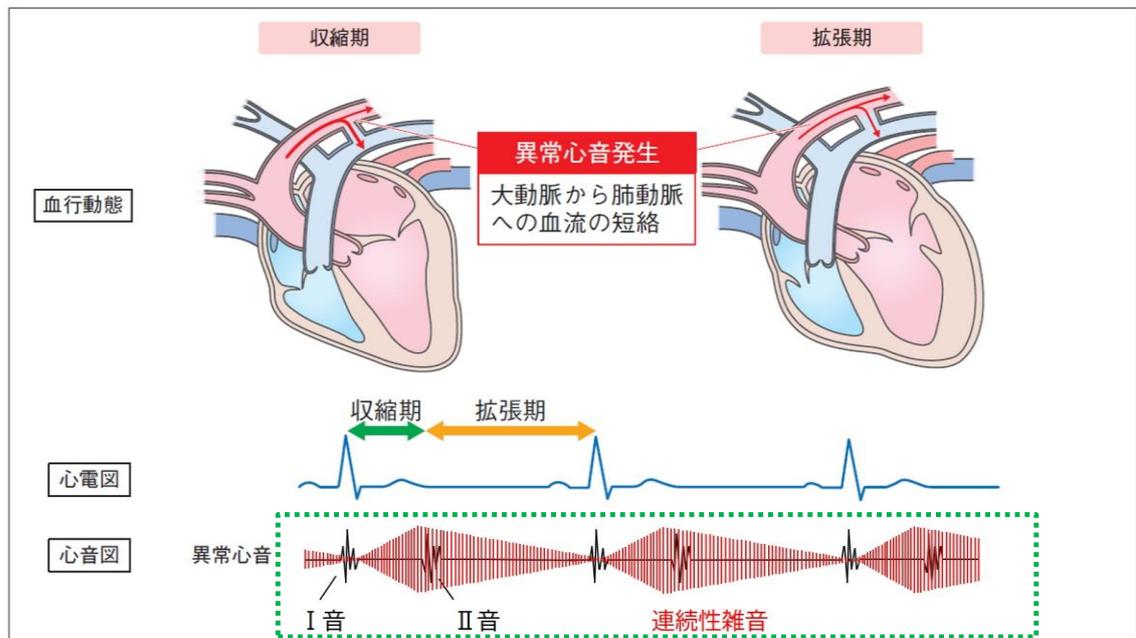


図 3-1-5 動脈管開存症における連続性雑音の発生

心雑音のピークはII音、もしくはII音直前であることが一般的である。

p.78
図3-1-5
心音図

訂正箇所

p.115
図3-10-4
異常心音①②
音声QRコード

図内に掲載している異常心音①②の音声QRコードに誤りがございました。「僧帽弁閉鎖不全症による異常心音」を視聴いただく際は、URLを打ち込んでいただくか、下記のQRコードを読み取ってアクセスしてください。



異常心音①
<https://eqm.page.link/AHVV>



異常心音②
<https://eqm.page.link/afgH>

※なお、書籍掲載のQRコードからはp.29の「正常な犬の心音」「正常な猫の心音」に遷移します。URLには誤りはありません。